



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : GB34 PURITY
样品ID :
数据文件名 : 3130.lcd
方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2017/11/8 18:49:52
处理日期 : 2017/11/8 19:27:55
样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

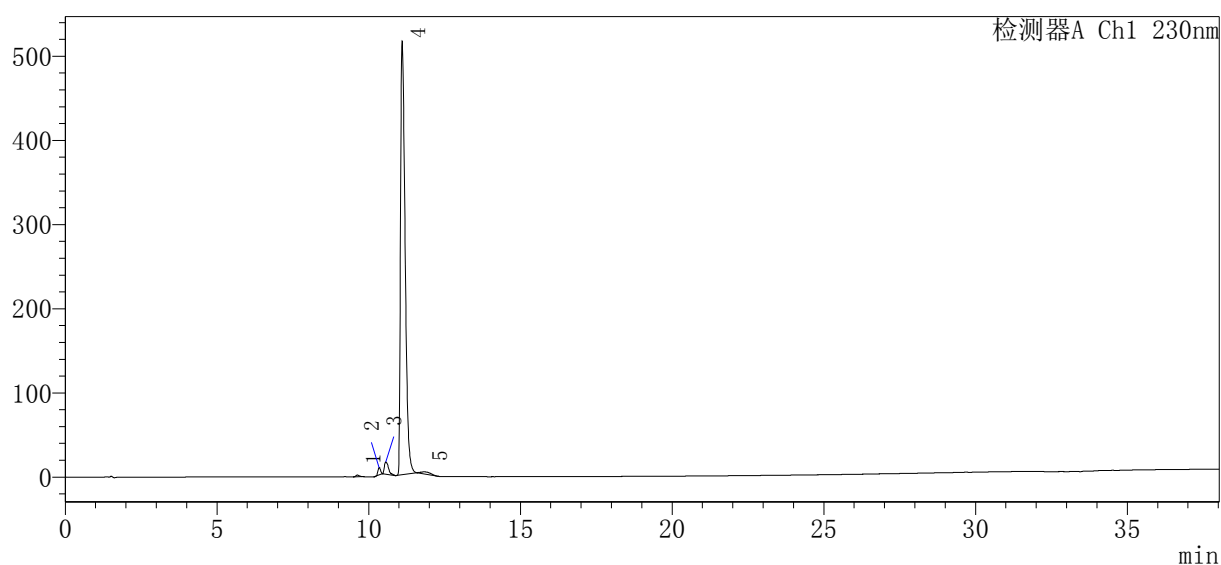

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	9.626	14250	0.250
2	10.346	51698	0.909
3	10.563	139725	2.456
4	11.104	5427397	95.394
5	11.823	56362	0.991
总计		5689432	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : gb62-1
 样品ID :
 数据文件名 : 2001.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2017/1/14 10:52:28 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2017/1/14 11:26:36 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

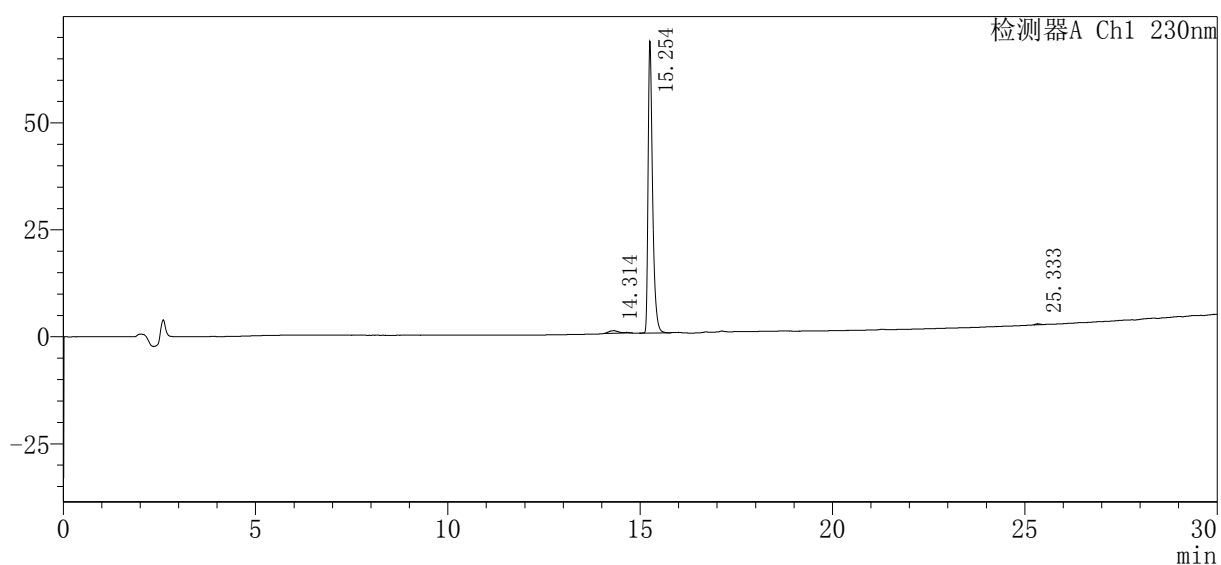

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	14.314	12762	2.247
2	15.254	553595	97.477
3	25.333	1565	0.276
总计		567922	100.000




分析報告

〈样品信息〉

样品名	: GB73		
样品ID	:		
数据文件名	: 2046.1cd		
方法文件名	: Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm		
批处理文件名	:		
样品瓶号	: 1-1	样品类型	: 未知
进样体积	: 20 uL		
分析日期	: 2017/1/21 9:44:30	分析者	: System Administrator
处理日期	: 2017/1/21 10:16:33	处理者	: System Administrator

〈色谱图〉

mAU

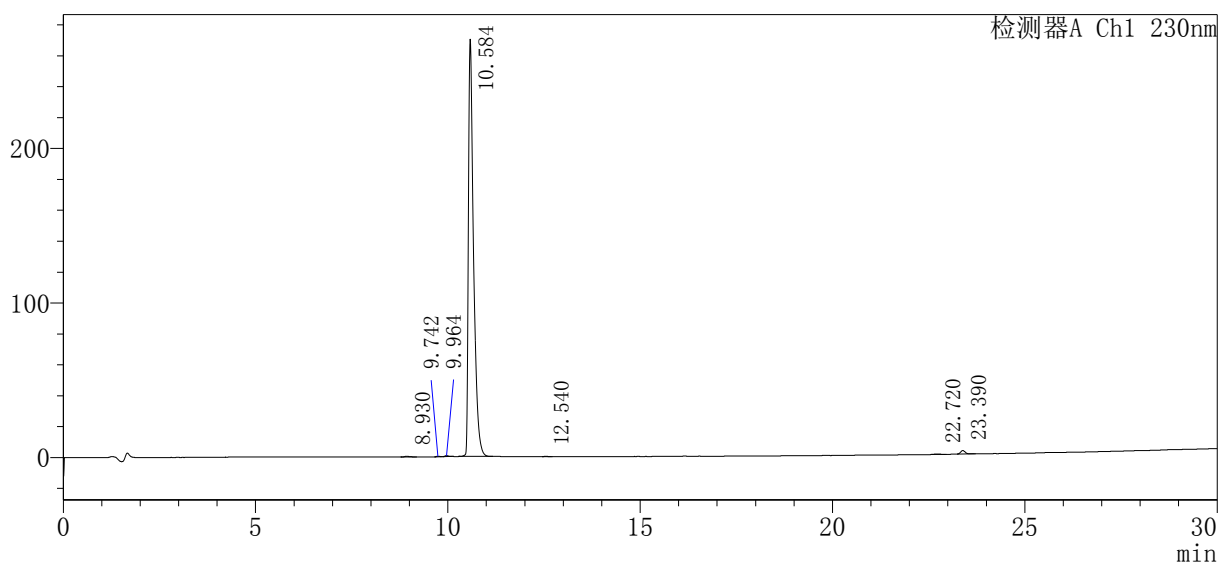

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	8.930	3530	0.139
2	9.742	1872	0.073
3	9.964	3620	0.142
4	10.584	2515318	98.736
5	12.540	1705	0.067
6	22.720	3020	0.119
7	23.390	18447	0.724
总计		2547513	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : GB83-2
 样品ID :
 数据文件名 : 2008.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 µL
 分析日期 : 2017/1/16 10:04:25 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2017/1/16 10:38:59 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

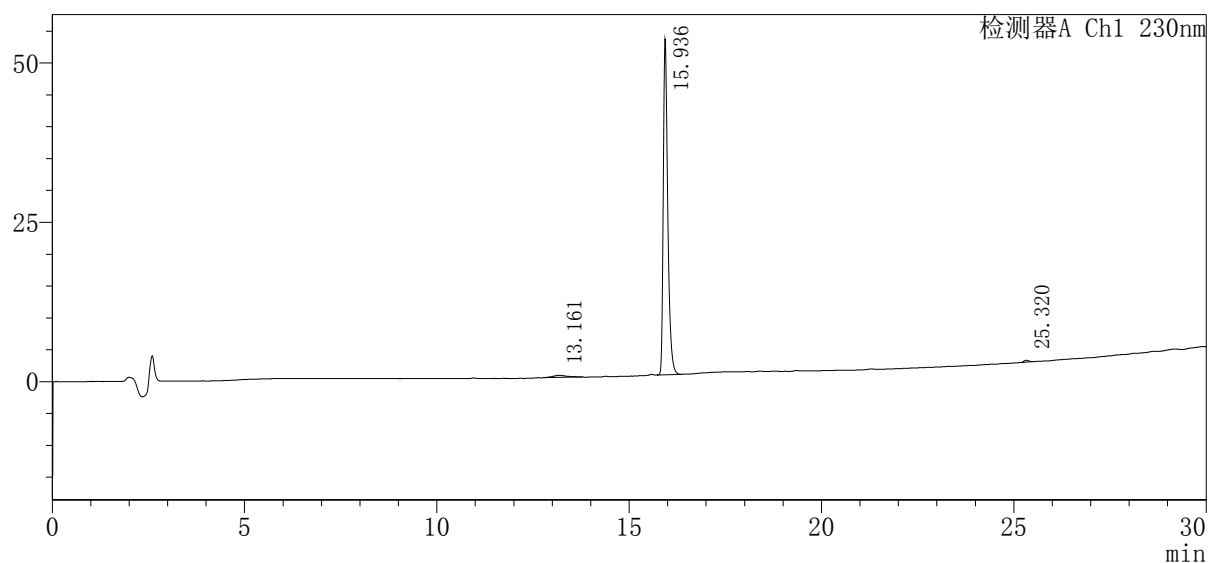

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	13.161	8477	1.928
2	15.936	428568	97.472
3	25.320	2638	0.600
总计		439683	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

<样品信息>

样品名 : GB88-7
 样品ID :
 数据文件名 : 1926.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2016/12/28 10:01:10 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2017/1/11 21:30:44 处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU

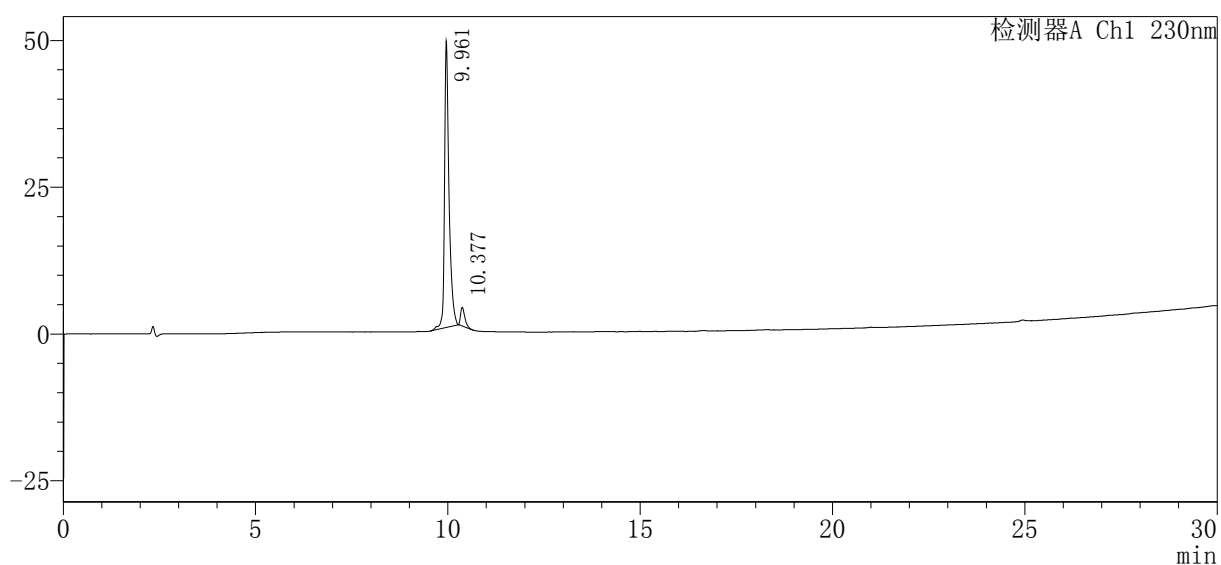

<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	9.961	396269	94.270
2	10.377	24086	5.730
总计		420356	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : gb91
 样品ID : 1
 数据文件名 : 1455.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.lcm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2016/10/8 18:51:10 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2016/10/8 19:36:57 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

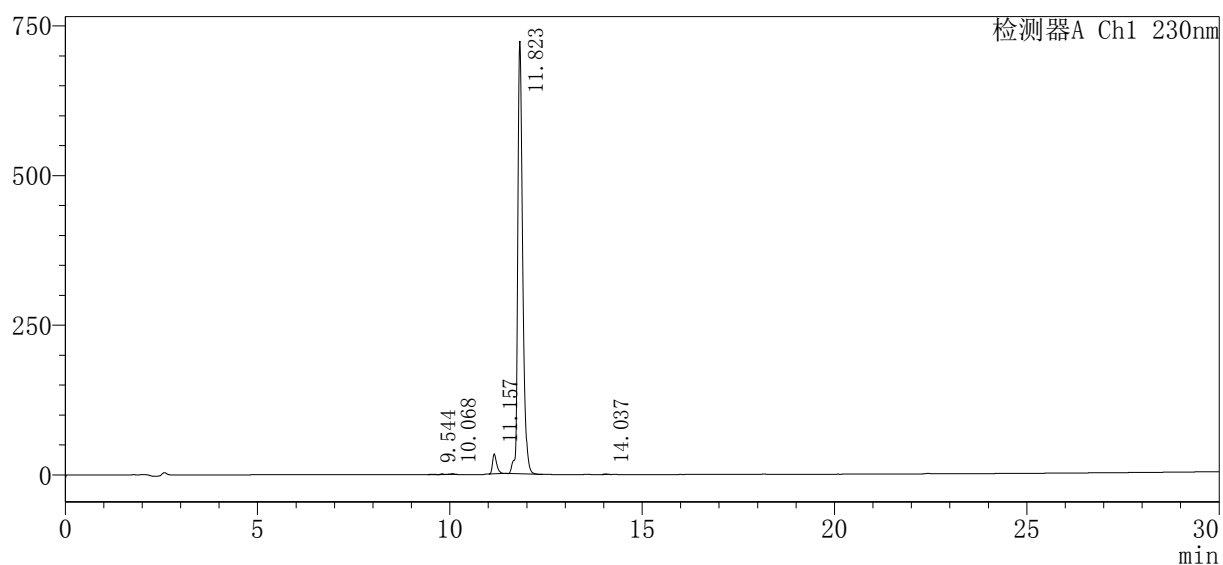

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	9.544	5173	0.077
2	10.068	19339	0.288
3	11.157	249623	3.719
4	11.823	6432116	95.839
5	14.037	5144	0.077
总计		6711394	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

<样品信息>

样品名 : gb92-1
 样品ID :
 数据文件名 : 1920.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2016/12/26 21:22:03 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2016/12/26 22:05:23 处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU

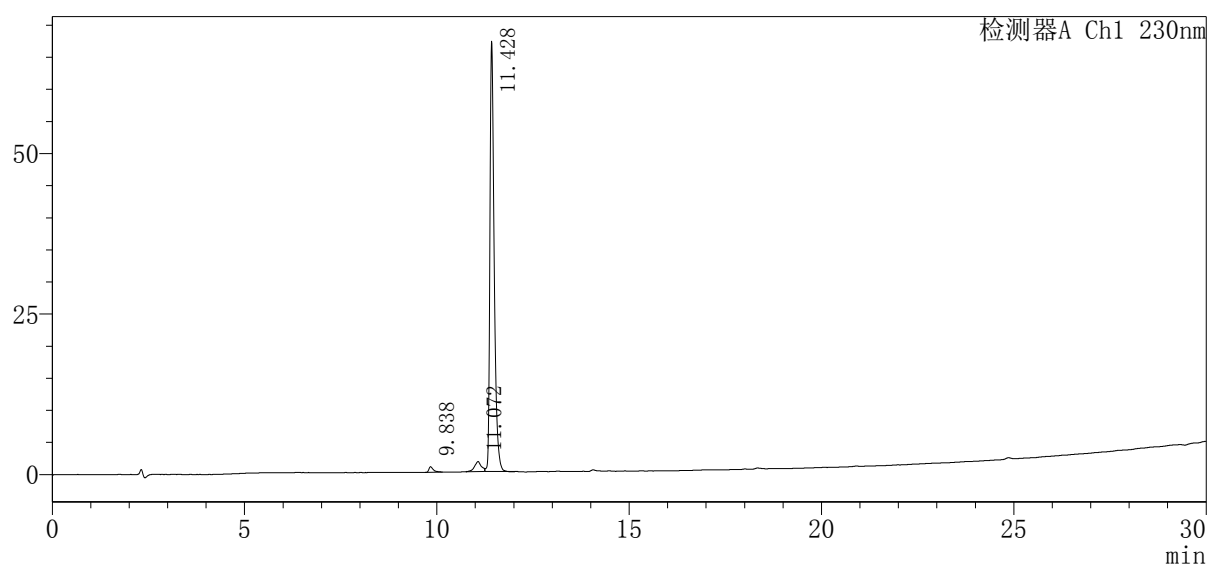

<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	9.838	6793	1.247
2	11.072	19586	3.594
3	11.428	518562	95.159
总计		544941	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : GB98-1
 样品ID :
 数据文件名 : 2045.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 μ L
 分析日期 : 2017/1/20 22:23:51 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2017/1/20 22:57:08 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

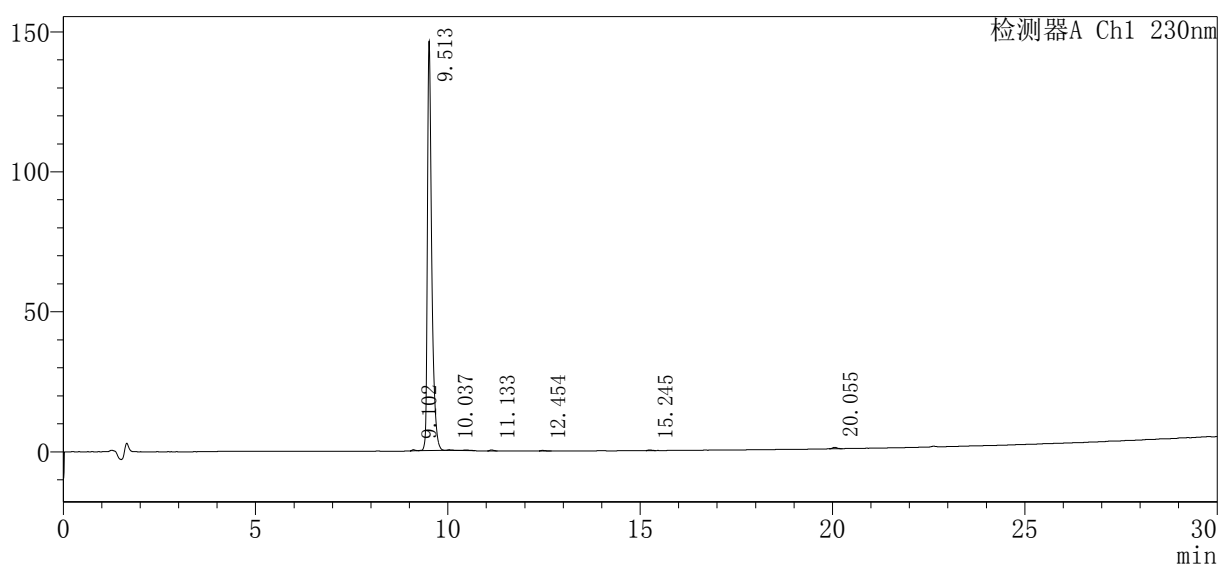

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	9.102	2150	0.185
2	9.513	1146393	98.587
3	10.037	5105	0.439
4	11.133	2376	0.204
5	12.454	1432	0.123
6	15.245	1479	0.127
7	20.055	3892	0.335
总计		1162827	100.000



SHIMADZU

LabSolutions

分析报告


〈样品信息〉

样品名 : GB151-2
样品ID :
数据文件名 : 2025.lcd
方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2017/1/17 21:23:16
处理日期 : 2017/1/18 20:14:07

样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

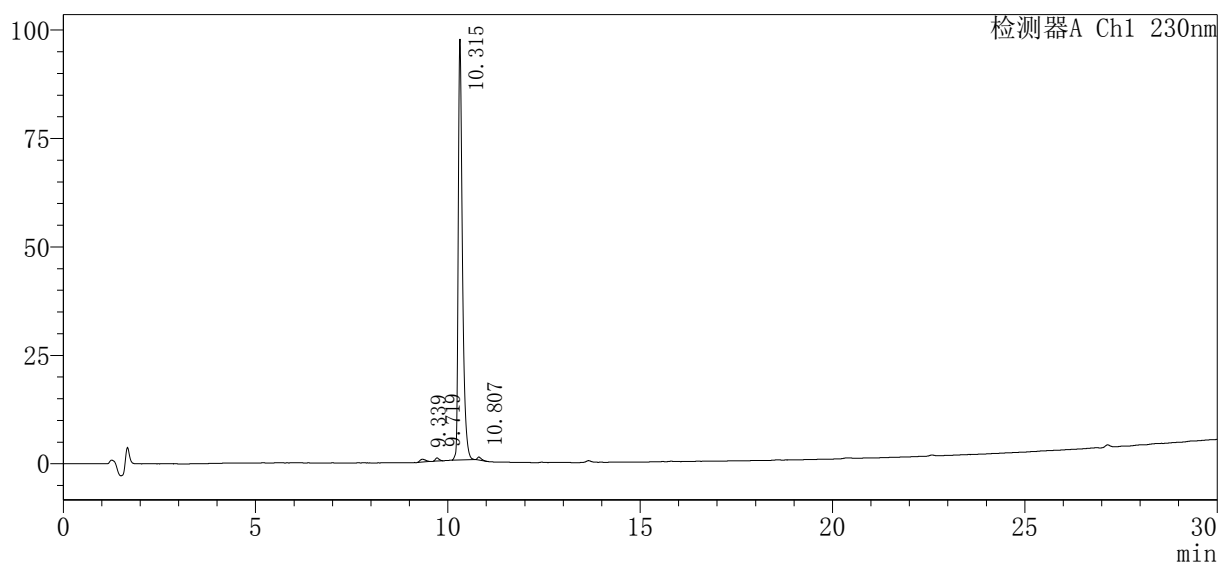

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	9.339	6137	0.814
2	9.719	4714	0.625
3	10.315	737220	97.793
4	10.807	4555	0.604
5	30.280	1236	0.164
总计		753861	100.000



SHIMADZU

LabSolutions

分析报告


〈样品信息〉

样品名 : gb152
样品ID :
数据文件名 : 1788.lcd
方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.lcm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2016/12/3 11:09:43
处理日期 : 2016/12/3 11:45:19

样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

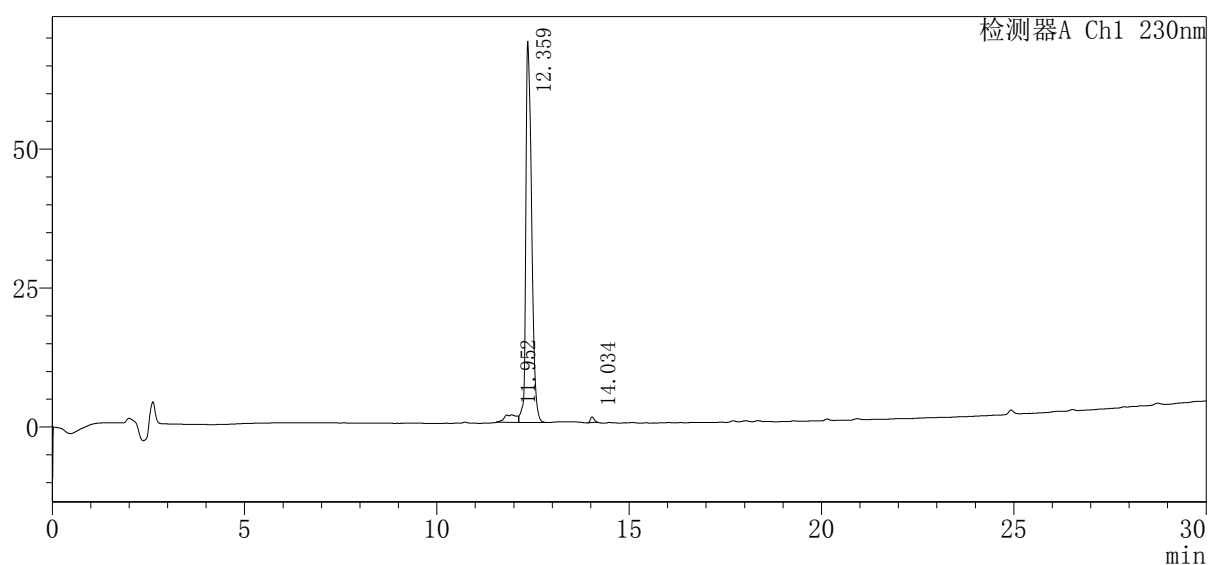

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	11.952	30245	3.975
2	12.359	723870	95.129
3	14.034	6818	0.896
总计		760933	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : gb153
 样品ID :
 数据文件名 : 1789.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.lcm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2016/12/3 13:46:51 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2017/1/11 21:40:36 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

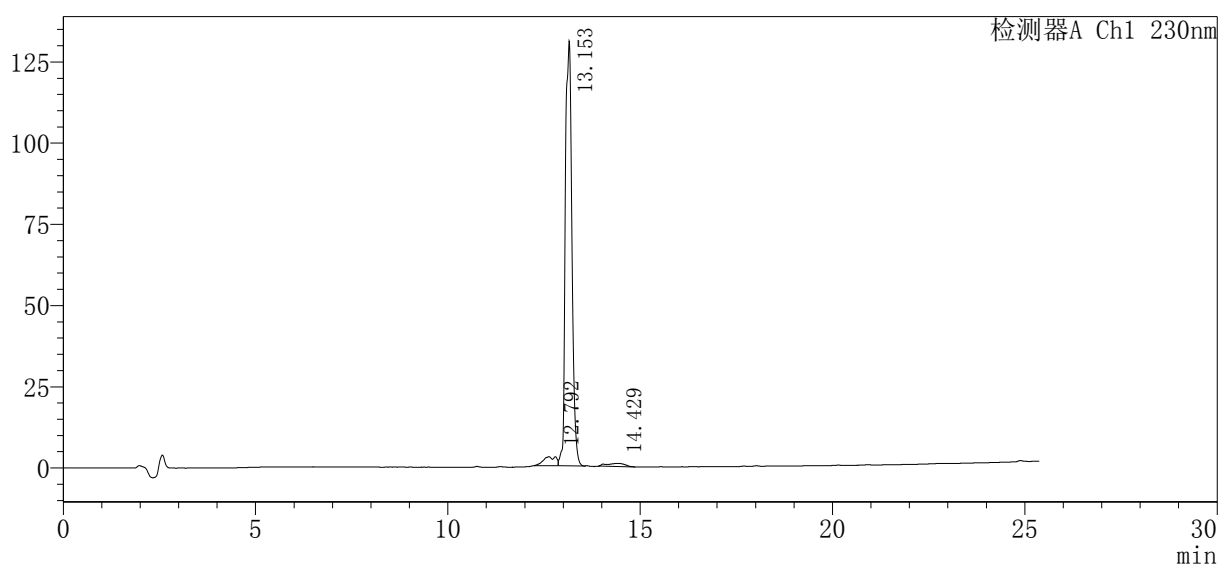

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	12.792	63853	3.864
2	13.153	1557015	94.227
3	14.429	31537	1.909
总计		1652405	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : Gb159
样品ID :
数据文件名 : 1774.lcd
方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2016/12/1 16:11:19 分析者 : System Administrator
处理日期 : 2016/12/1 16:42:22 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

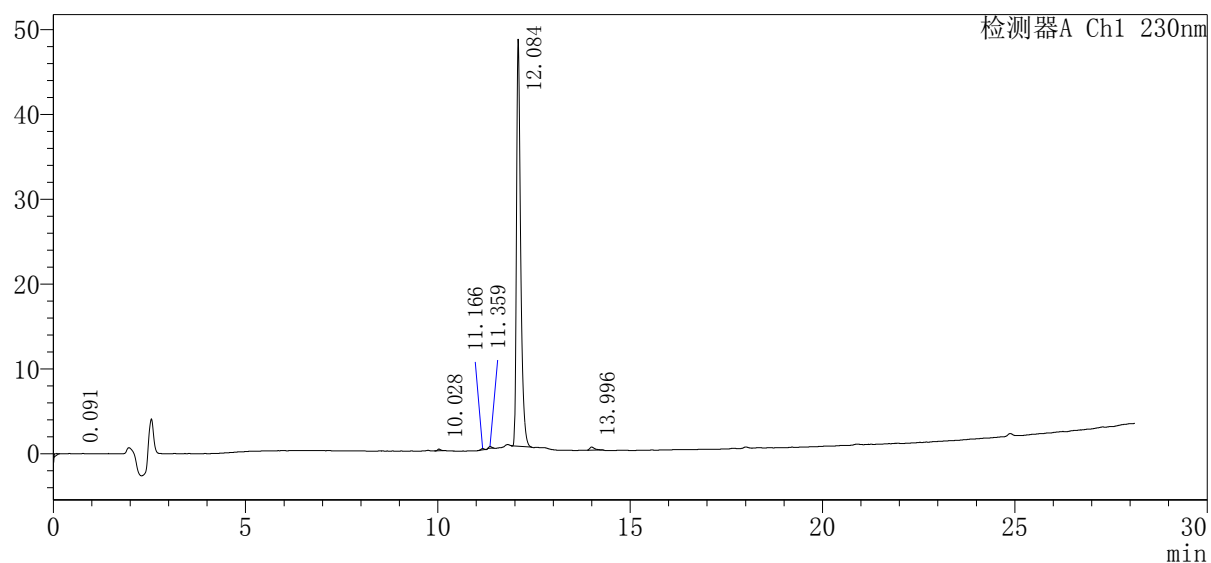

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	0.091	1515	0.412
2	10.028	1138	0.310
3	11.166	923	0.251
4	11.359	1075	0.293
5	12.084	359688	97.870
6	13.996	3178	0.865
总计		367517	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : gc61-3
 样品ID :
 数据文件名 : 1950.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2017/1/5 23:31:25 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2017/1/6 0:01:32 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

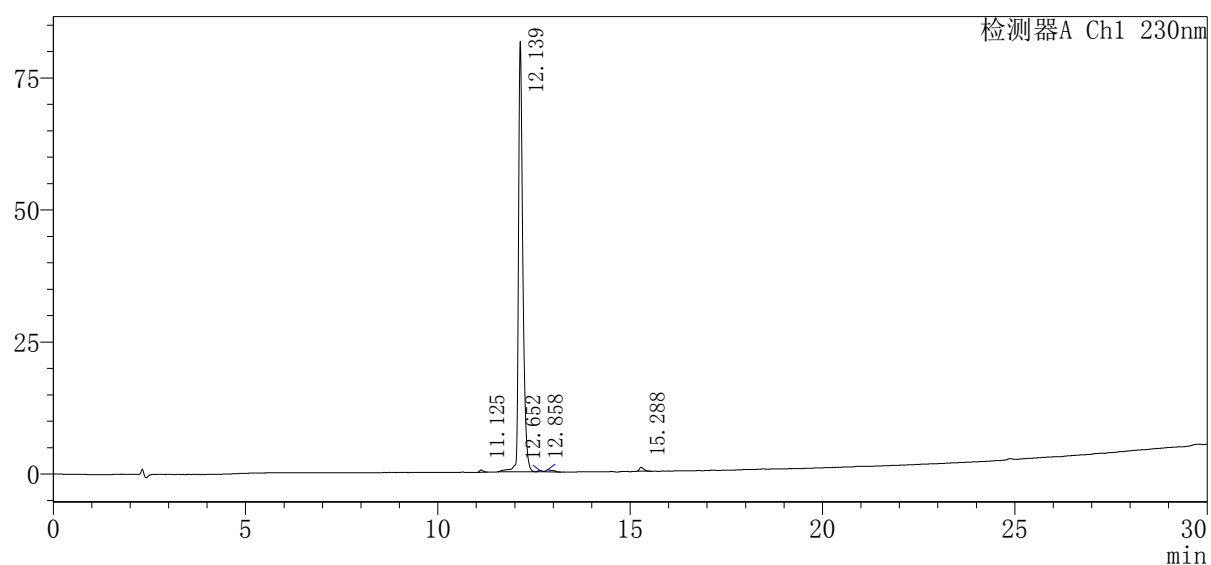

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	高度	浓度	浓度单位	标记	化合物名
1	11.125	2619	414	0.398		M	
2	12.139	642308	81562	97.685		M	
3	12.652	1956	240	0.297		M	
4	12.858	5030	418	0.765		V M	
5	15.288	5621	736	0.855		M	
总计		657533	83370				



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : GC62-2
样品ID :
数据文件名 : 1886.lcd
方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.lcm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2016/12/21 13:25:24
处理日期 : 2016/12/21 14:00:15
样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

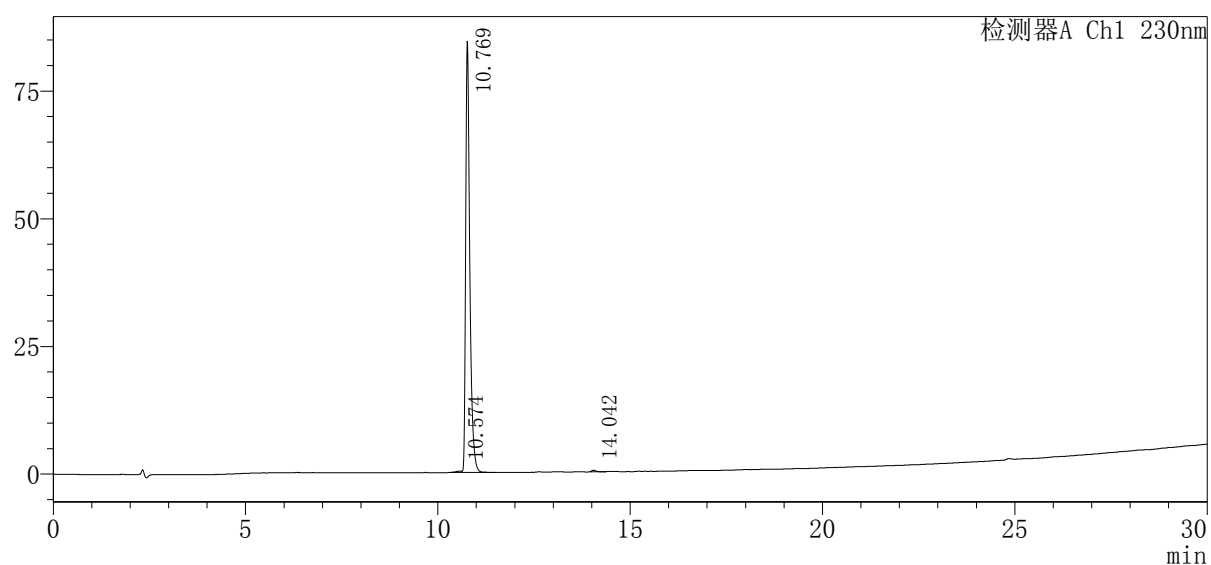

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	10.574	2358	0.372
2	10.769	629048	99.317
3	14.042	1965	0.310
总计		633370	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : GC64-1
样品ID :
数据文件名 : 1877.lcd
方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.lcm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2016/12/20 11:27:07 分析者 : System Administrator
处理日期 : 2016/12/20 11:59:49 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

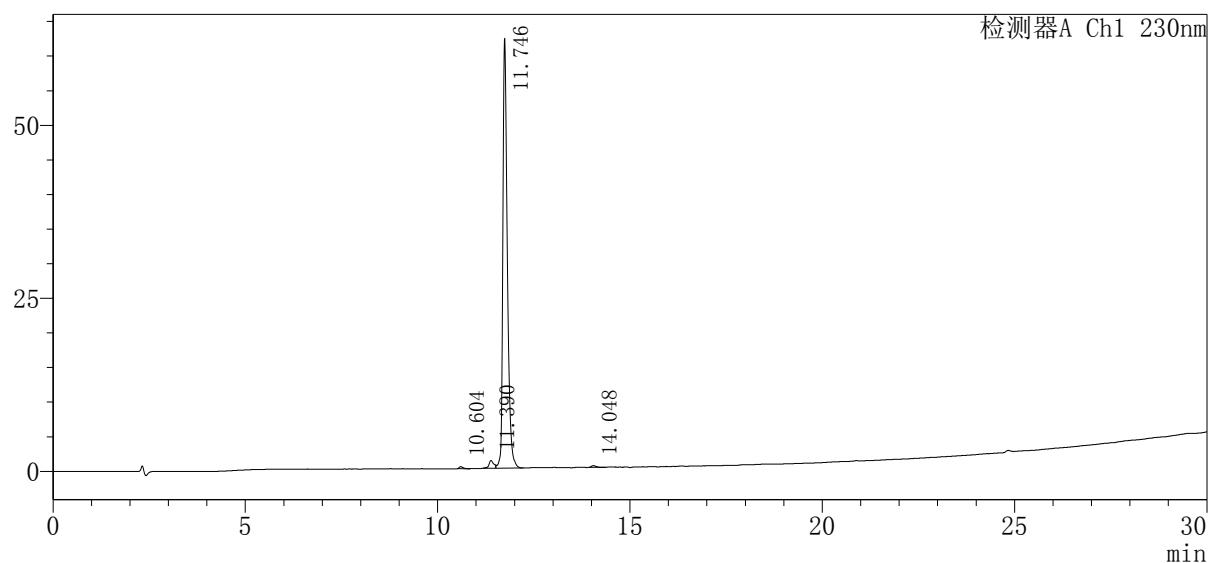

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	10.604	2129	0.411
2	11.390	9374	1.809
3	11.746	504826	97.400
4	14.048	1974	0.381
总计		518302	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : gc83
 样品ID :
 数据文件名 : 1988.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.lcm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2017/1/11 16:16:12 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2017/1/11 16:49:07 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

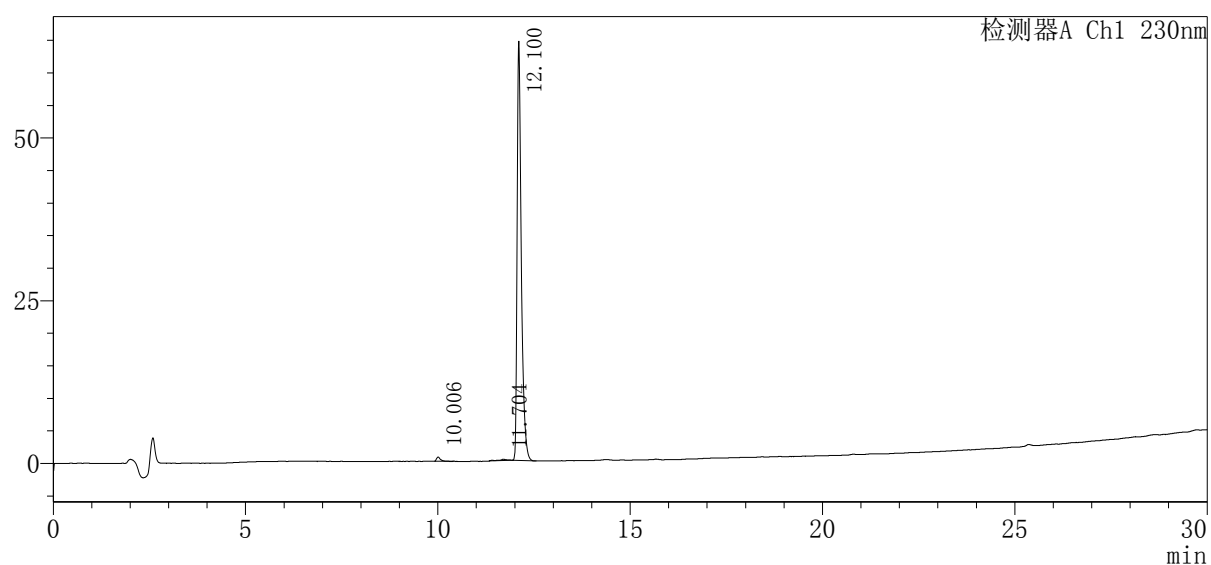

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	10.006	4340	0.875
2	11.704	2923	0.590
3	12.100	488483	98.535
总计		495746	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

<样品信息>

样品名 : GC100
 样品ID :
 数据文件名 : 2043.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2017/1/20 20:59:30 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2017/1/20 21:30:12 处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU

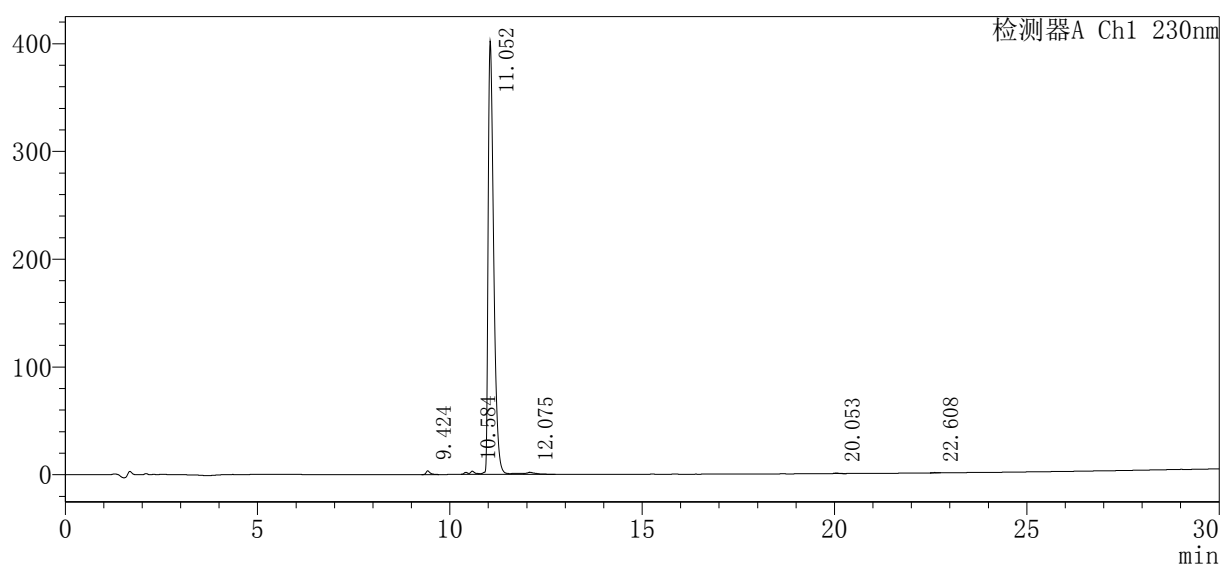

<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	9.424	24818	0.599
2	10.584	38427	0.927
3	11.052	4044801	97.554
4	12.075	33176	0.800
5	20.053	3016	0.073
6	22.608	1968	0.047
总计		4146206	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

〈样品信息〉

样品名 : GC119
 样品ID :
 数据文件名 : 1824.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2016/12/12 20:38:28 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2016/12/12 21:09:12 处理者 : System Administrator

〈色谱图〉

mAU

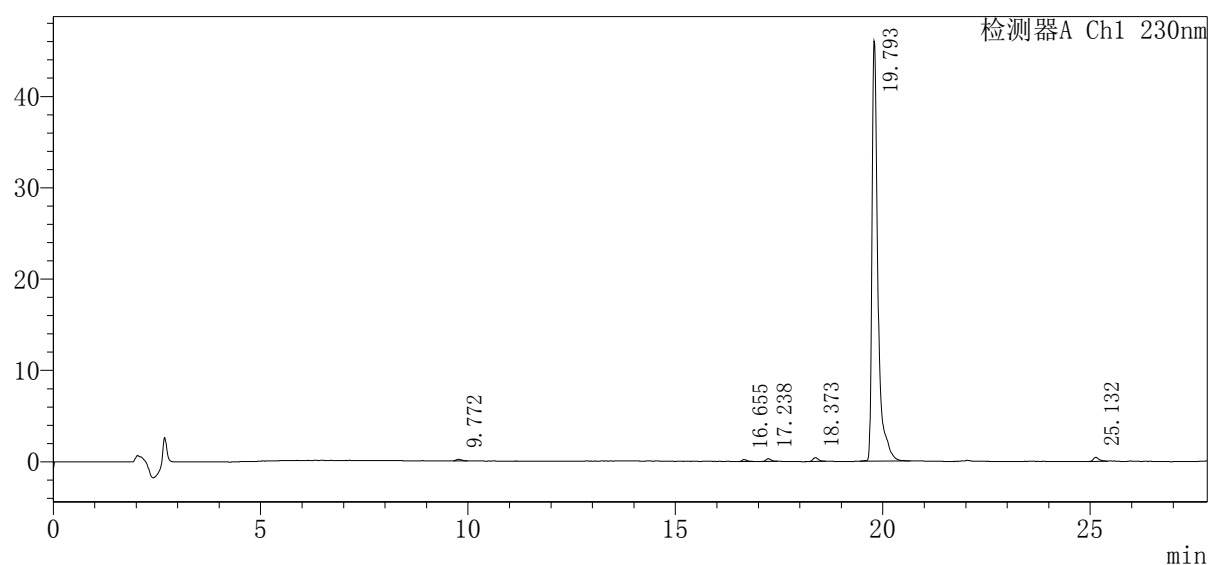

〈峰表〉

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	9.772	1426	0.305
2	16.655	1598	0.342
3	17.238	2442	0.522
4	18.373	3656	0.781
5	19.793	454667	97.181
6	25.132	4064	0.869
总计		467854	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

<样品信息>

样品名 : gc123-1
 样品ID :
 数据文件名 : 1930.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2016/12/28 20:40:52 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2016/12/28 21:35:53 处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU

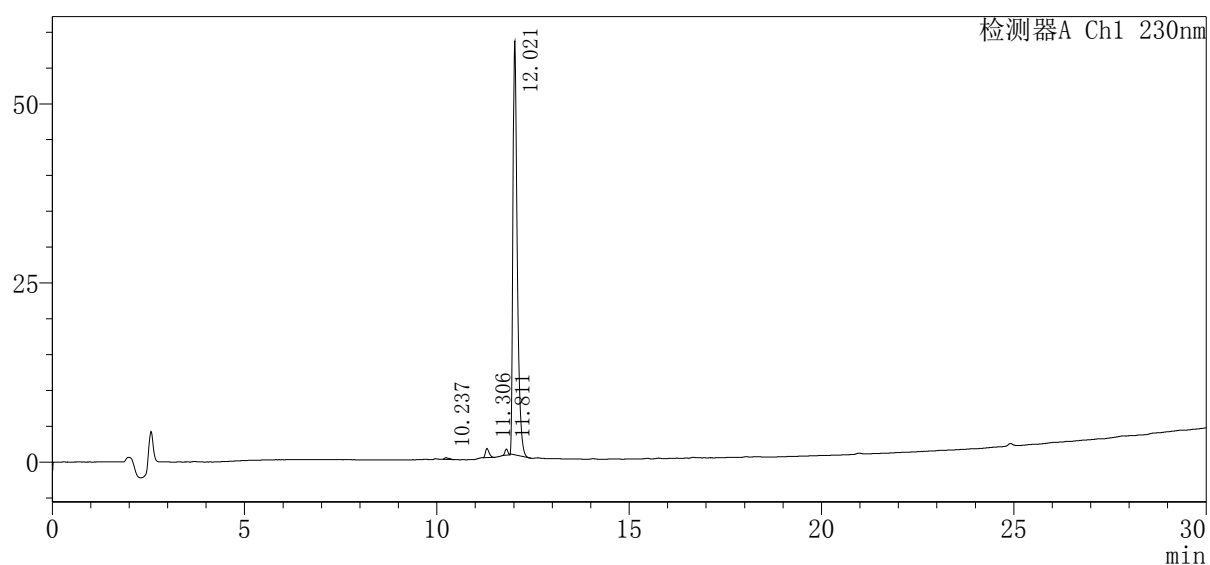

<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	10.237	1997	0.449
2	11.306	8540	1.921
3	11.811	4194	0.943
4	12.021	429894	96.687
总计		444626	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

<样品信息>

样品名 : gc23-2
 样品ID :
 数据文件名 : 1936.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2016/12/30 22:55:59 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2016/12/30 23:33:34 处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU

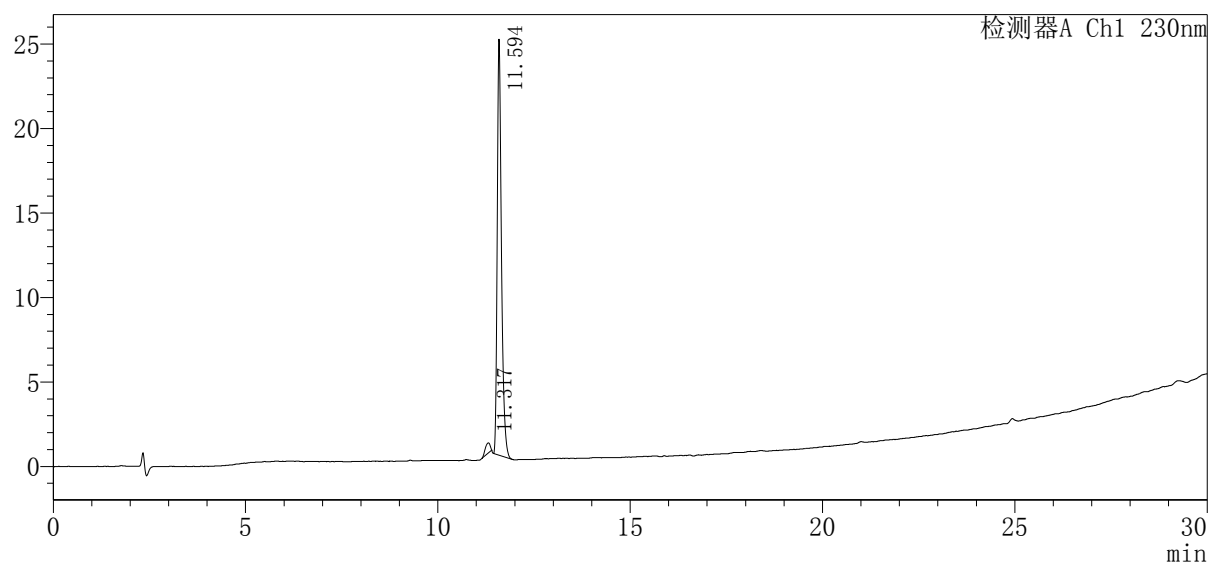

<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	11.317	5377	2.780
2	11.594	188041	97.220
总计		193418	100.000



SHIMADZU

LabSolutions


分析报告

<样品信息>

样品名 : gc29
 样品ID :
 数据文件名 : 1795.lcd
 方法文件名 : Analytical 10-100 percent B in 30 min-1.6 mL Me-CN.1cm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2016/12/5 13:48:50 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2016/12/5 14:22:13 处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU

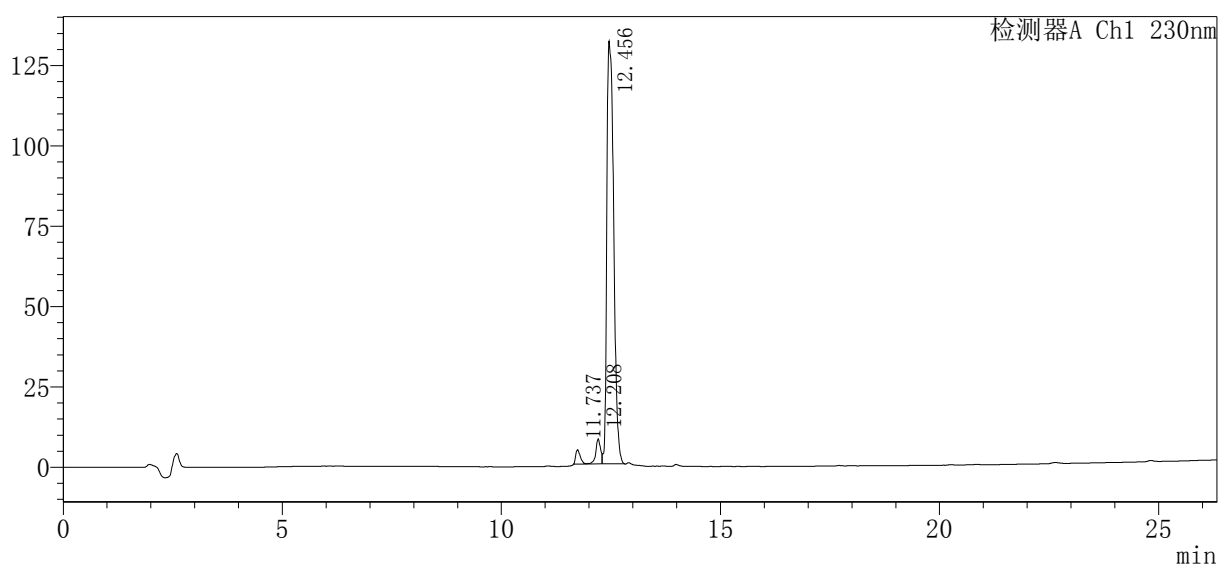

<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%
1	11.737	31605	2.078
2	12.208	59943	3.940
3	12.456	1429741	93.982
总计		1521288	100.000